

Renouvellement d'une dose : Anomalie de la dose à administrer en cas de modification

Les équipes de Logipren ont détecté une anomalie qui nécessite votre attention.


Versions concernées :

- 2.4.4 → ajout de la fonction “renouveler 1 fois”
- 2.5.1 (pas encore en production)

Conditions de reproduction du bug - Paramétrage Thésaurus des doses concernées :

- Dose de type “**administrer une fois**” (ie pour lesquelles la fonction “renouveler” est disponible)

THESAURUS :

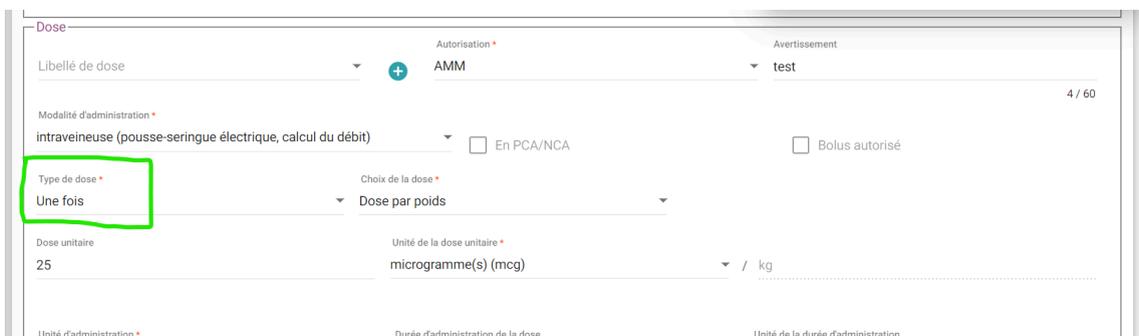

Dose

Libellé de dose AMM

Modaliété d'administration intraveineuse (pousse-seringue électrique, calcul du débit)

Type de dose **Une fois**

Choix de la dose Dose par poids

Dose unitaire 25

Unité de la dose unitaire microgramme(s) (mcg)

Mode de reproduction du bug (dans la prescription) :

- **Renouveler** la dose
- **Modifier la dose** (par exemple la quantité prescrite /kg, la purge, etc.)

PAGE PRESCRIPTION:

Hors AMM | TEST ED | 7 mars 2024 à 16h00 une fois | **Renouvelé 1 fois (07/03 - 16h01)**

Prescription : 6 mg/kg, soit 15 mg en intraveineuse, une fois

Préparation : Flacon de 500 mg, reconstituer avec 5 ml de EPPI soit 100 mg/ml;

(1/2) - Prendre 5 ml de la solution et ajouter 5 ml de G5%, on obtient 10 ml = 500 mg (50 mg/ml);

(2/2) - Prendre 0,6 ml, ajouter 1,4 ml de G5%, on obtient 2 ml = 30 mg (15 mg/ml);

Volume de purge (non administré au patient) 0 ml

Administration : Administrer 2 ml en intraveineuse (=30 mg; écart + 100%)

Bug :

- Le volume de la dose à administrer est **doublé**

MARCHE À SUIVRE :

Ne pas utiliser la fonction "renouveler les doses 1 fois"

Un correctif sera disponible pour déploiement dans les prochains jours